

## ERRATA CORRIGE 1

### NORMA CEI EN 60601-2-20 (CEI 62-41) Seconda Edizione: 1999-02 (fasc. 5031)

#### Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici da trasporto

Sostituire al paragrafo 6.8.2 il punto 2 con il seguente:

2)\* un avviso che indichi che un'INCUBATRICE DA TRASPORTO dovrebbe essere usata solo da personale opportunamente istruito e sotto la direzione di personale medico competente consapevole dei rischi e dei vantaggi generalmente conosciuti nell'utilizzo dell'INCUBATRICE DA TRASPORTO;

Sostituire il paragrafo 49.2 con il seguente:

L'APPARECCHIO deve essere progettato in modo che l'interruzione e il ripristino dell'ALIMENTAZIONE ELETTRICA non modifichino la TEMPERATURA IMPOSTATA e degli altri valori impostati. La conformità si verifica interrompendo e ripristinando l'ALIMENTAZIONE ELETTRICA e verificando l'APPARECCHIO.

Sostituire il paragrafo 50.107 con il seguente:

Con un'INCUBATRICE DA TRASPORTO funzionante come un'INCUBATRICE DA TRASPORTO CONTROLLATA IN BASE ALLA TEMPERATURA DELL'ARIA, la temperatura media non deve differire dalla TEMPERATURA IMPOSTATA di non oltre  $\pm 2$  °C ad una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 20 °C e di non oltre  $\pm 1,5$  ad una temperatura compresa tra 20 °C e 30 °C.

Prima della Fig. 102 di pagina 29 inserire la seguente fig. 101:

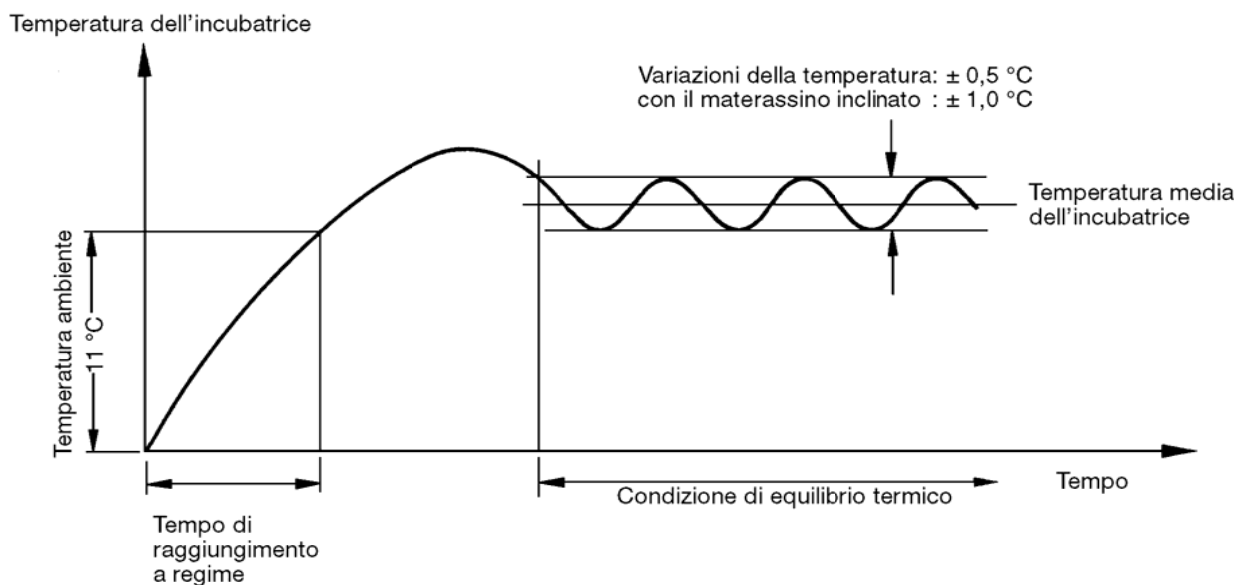


Fig. 101